


# 検体用 冷凍庫

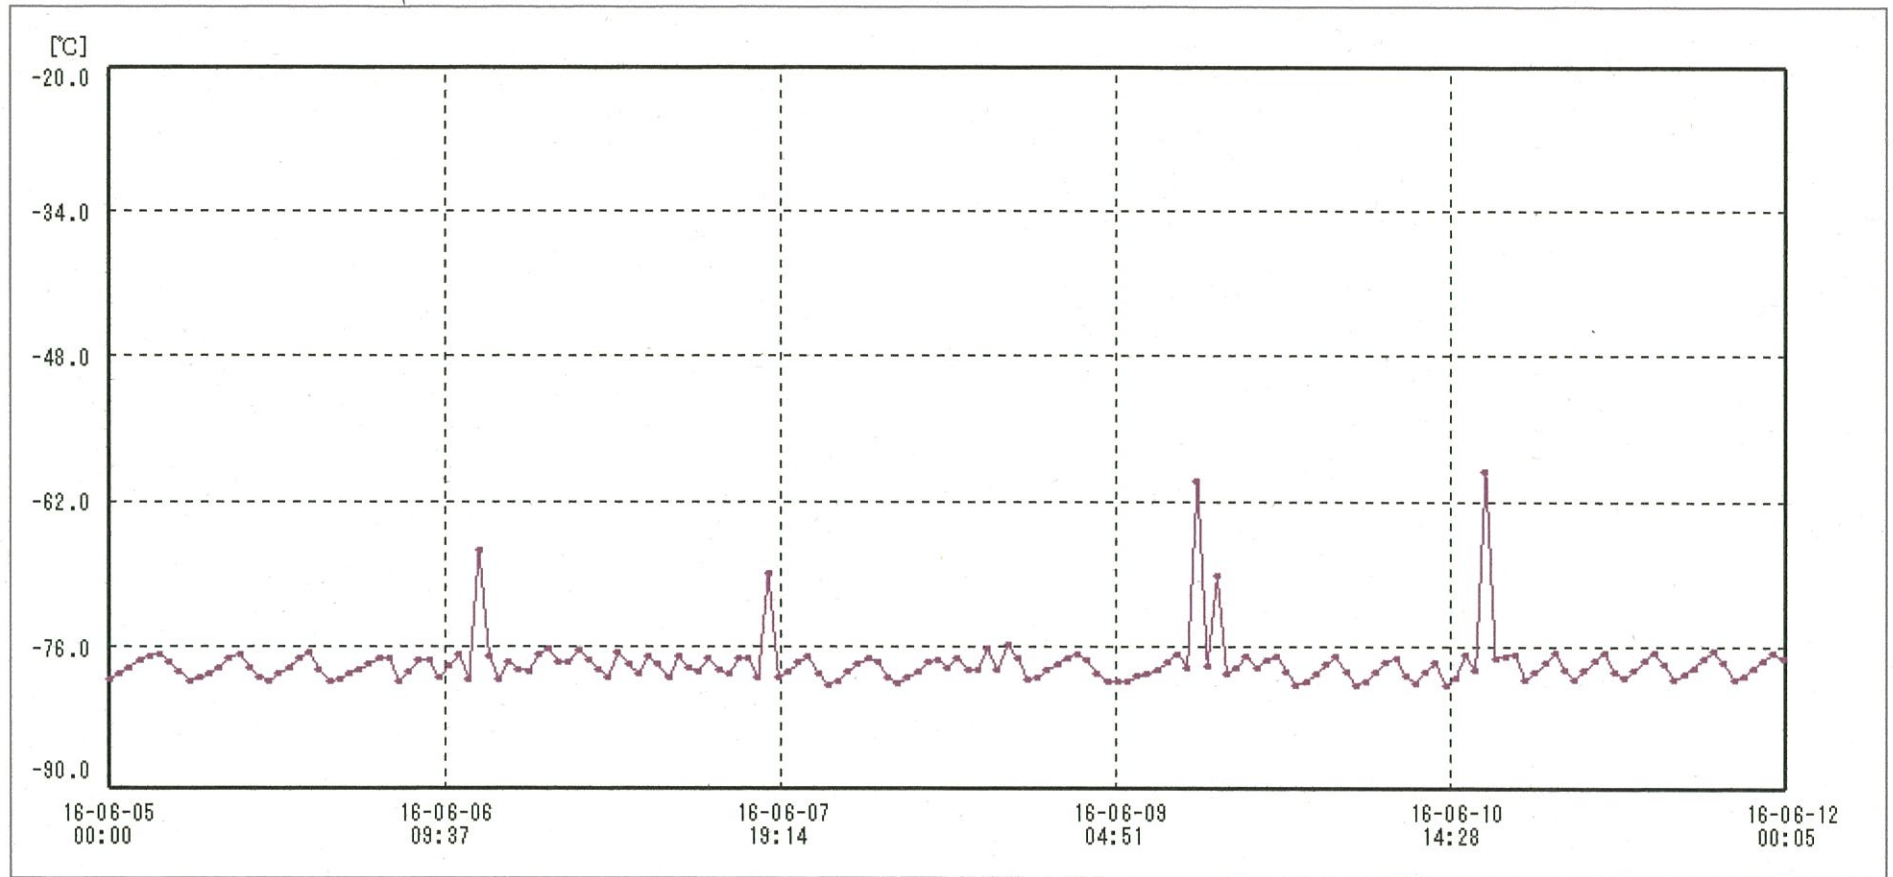

送信器名称 CH番号	冷蔵庫 CH1	冷凍庫 CH1
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	°C	°C
収録データ数	169	169
欠損データ数	0	0
測定間隔	01:00:00	01:00:00
最高値	5.9	-59.1
最低値	4.3	-79.7
平均値	4.8	-77.6

14-Jun-2016 南原沙織