


≠ 検体用 冷凍庫

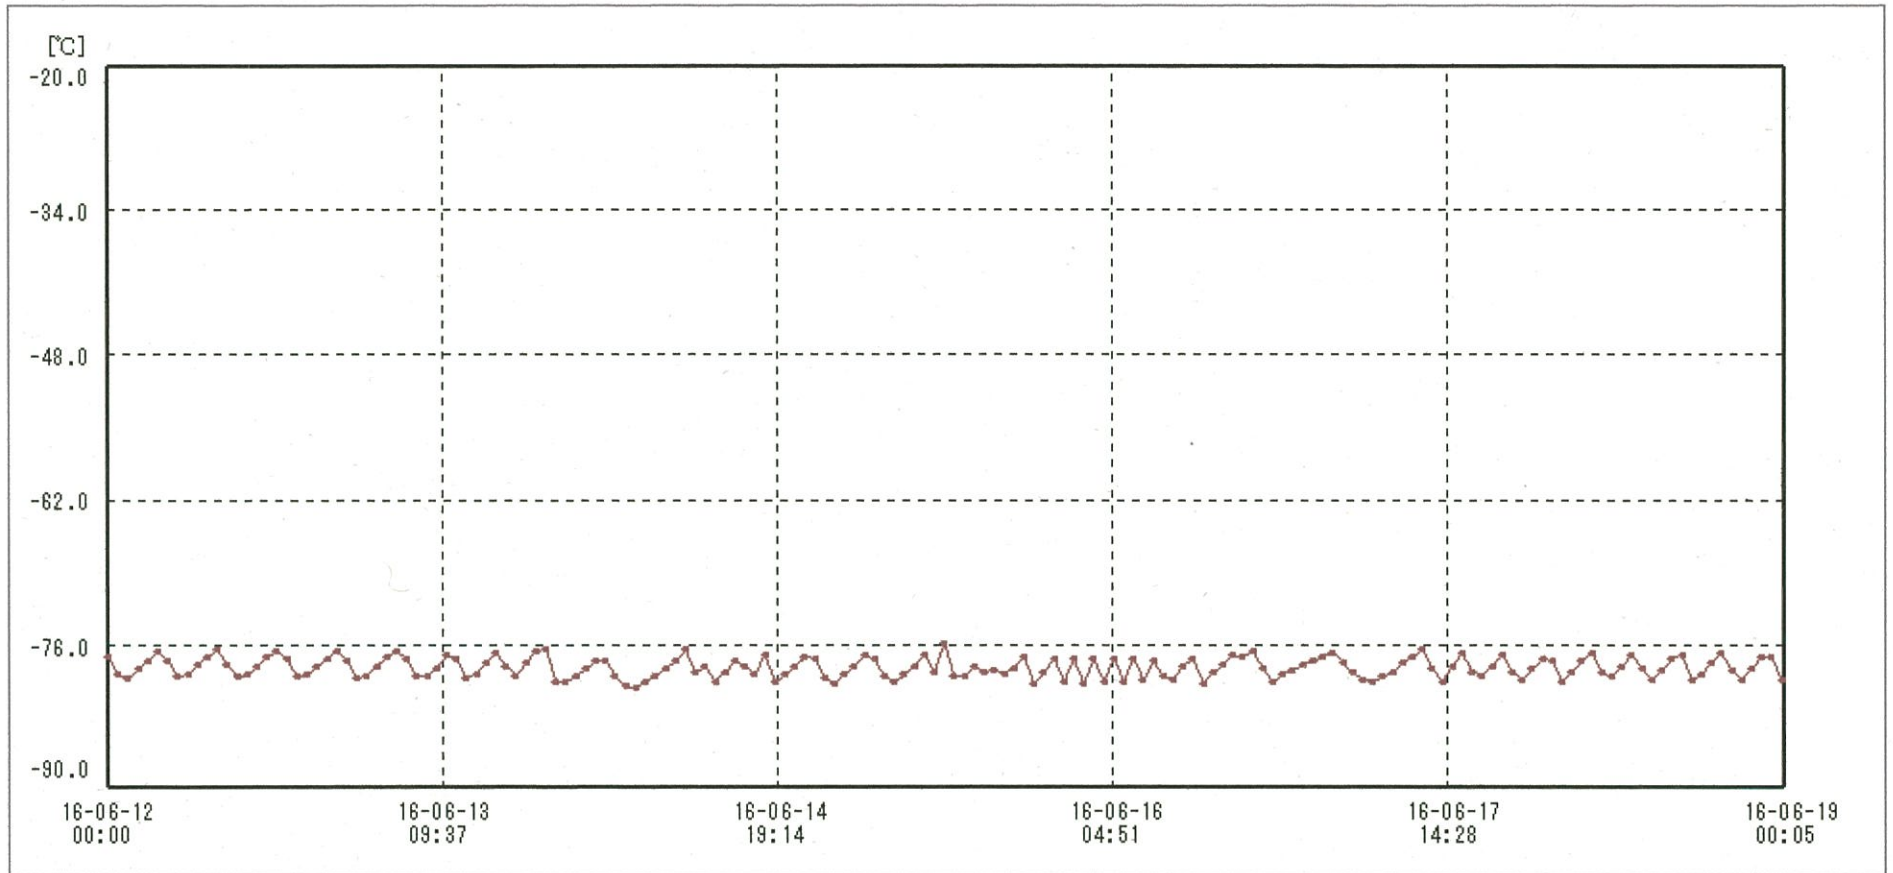

| 送信器名称 CH番号 | 冷凍庫 CH1 |
|---------------|-------------------------------------|
| ▶ グラフ表示 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 単位 | °C |
| 収録データ数 | 169 |
| 欠損データ数 | 0 |
| 測定間隔 | 01:00:00 |
| 最高値 | -75.8 |
| 最低値 | -80.2 |
| 平均値 | -78.2 |

21-Jun-2016 南原沙織