


7 検体用 冷凍庫

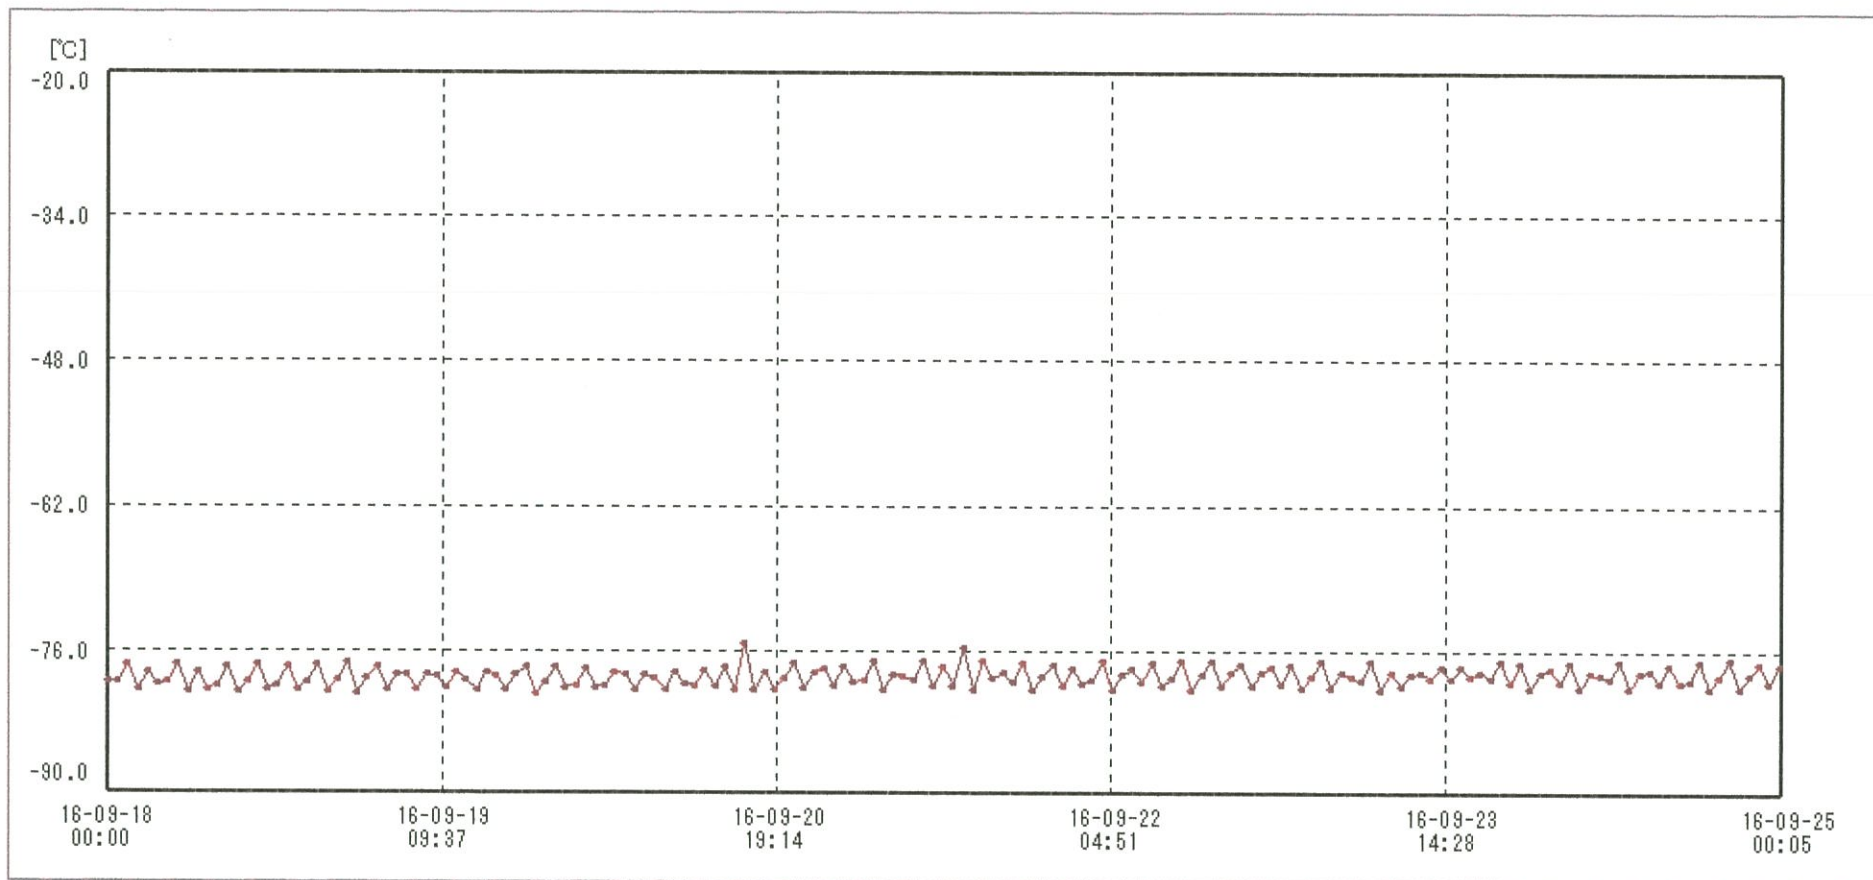

送信器名称 CH番号	冷凍庫 CH1
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃
収録データ数	169
欠損データ数	0
測定間隔	01:00:00
最高値	-75.2
最低値	-80.1
平均値	-78.5

27-SEP-2016

南原 沙織