


# 検体用 冷凍庫

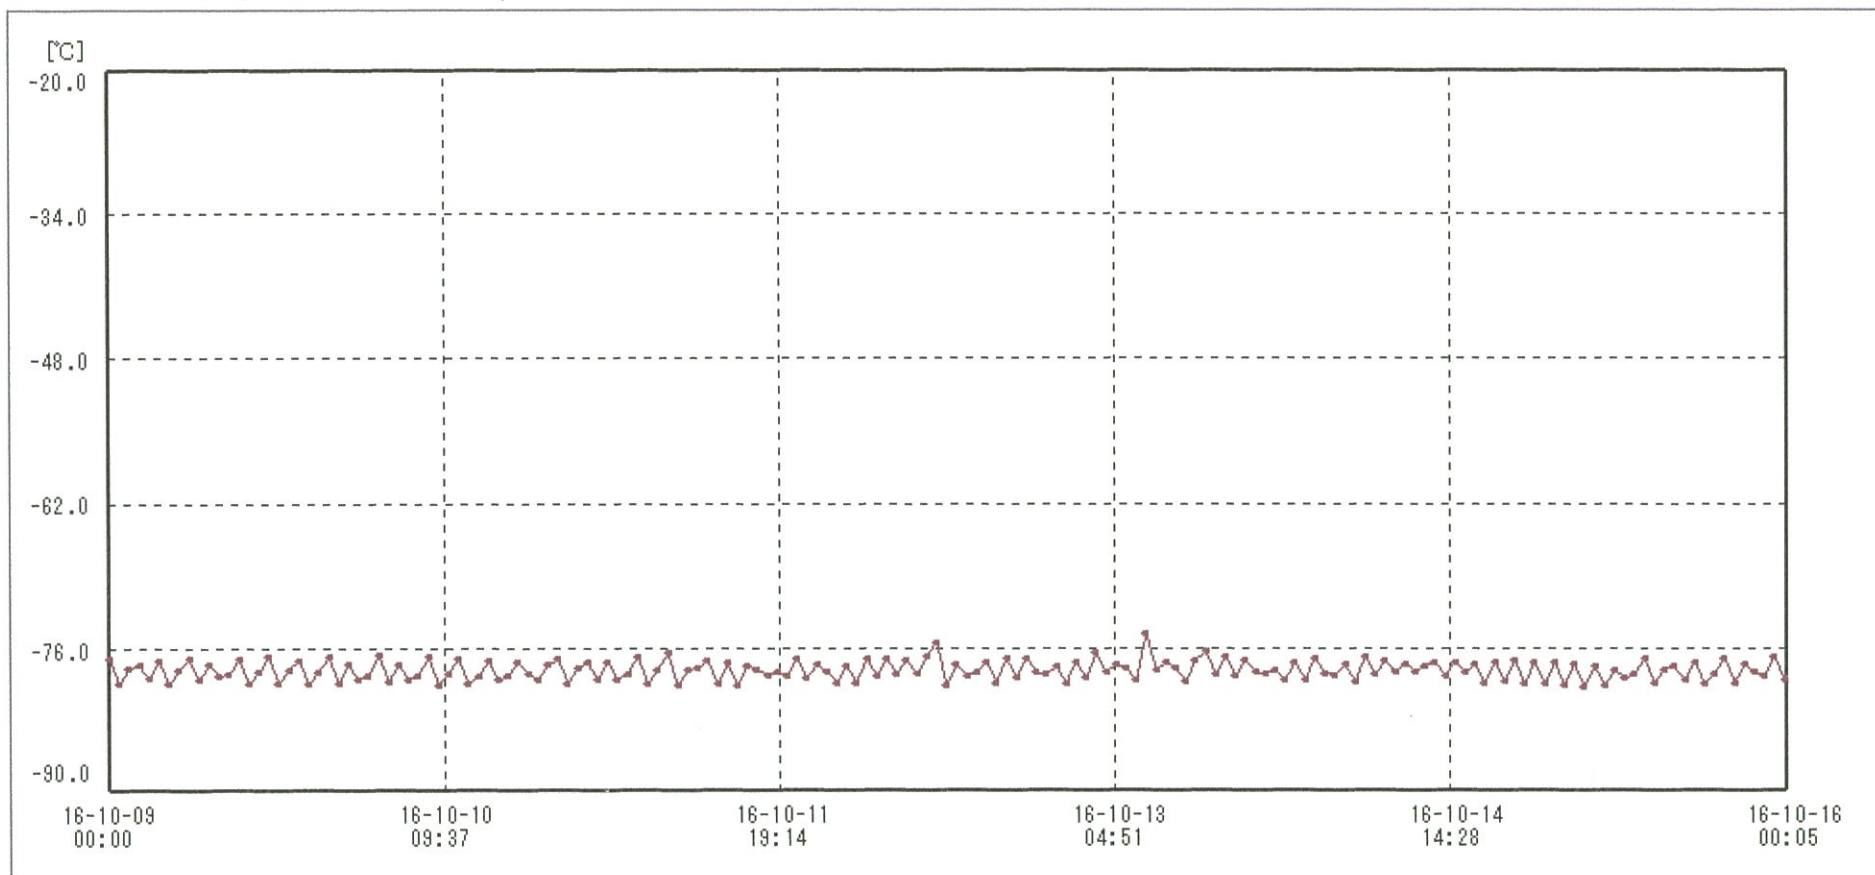

送信器名称 CH番号	冷凍庫 CH1
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	°C
収録データ数	169
欠損データ数	0
測定間隔	01:00:00
最高値	-74.5
最低値	-79.7
平均値	-78.1

18-Oct-2016 南原沙織