


2/3 15:30 -80℃冷凍庫を同型の代替機へ交換
 2/4 9:00まで保管検体なし

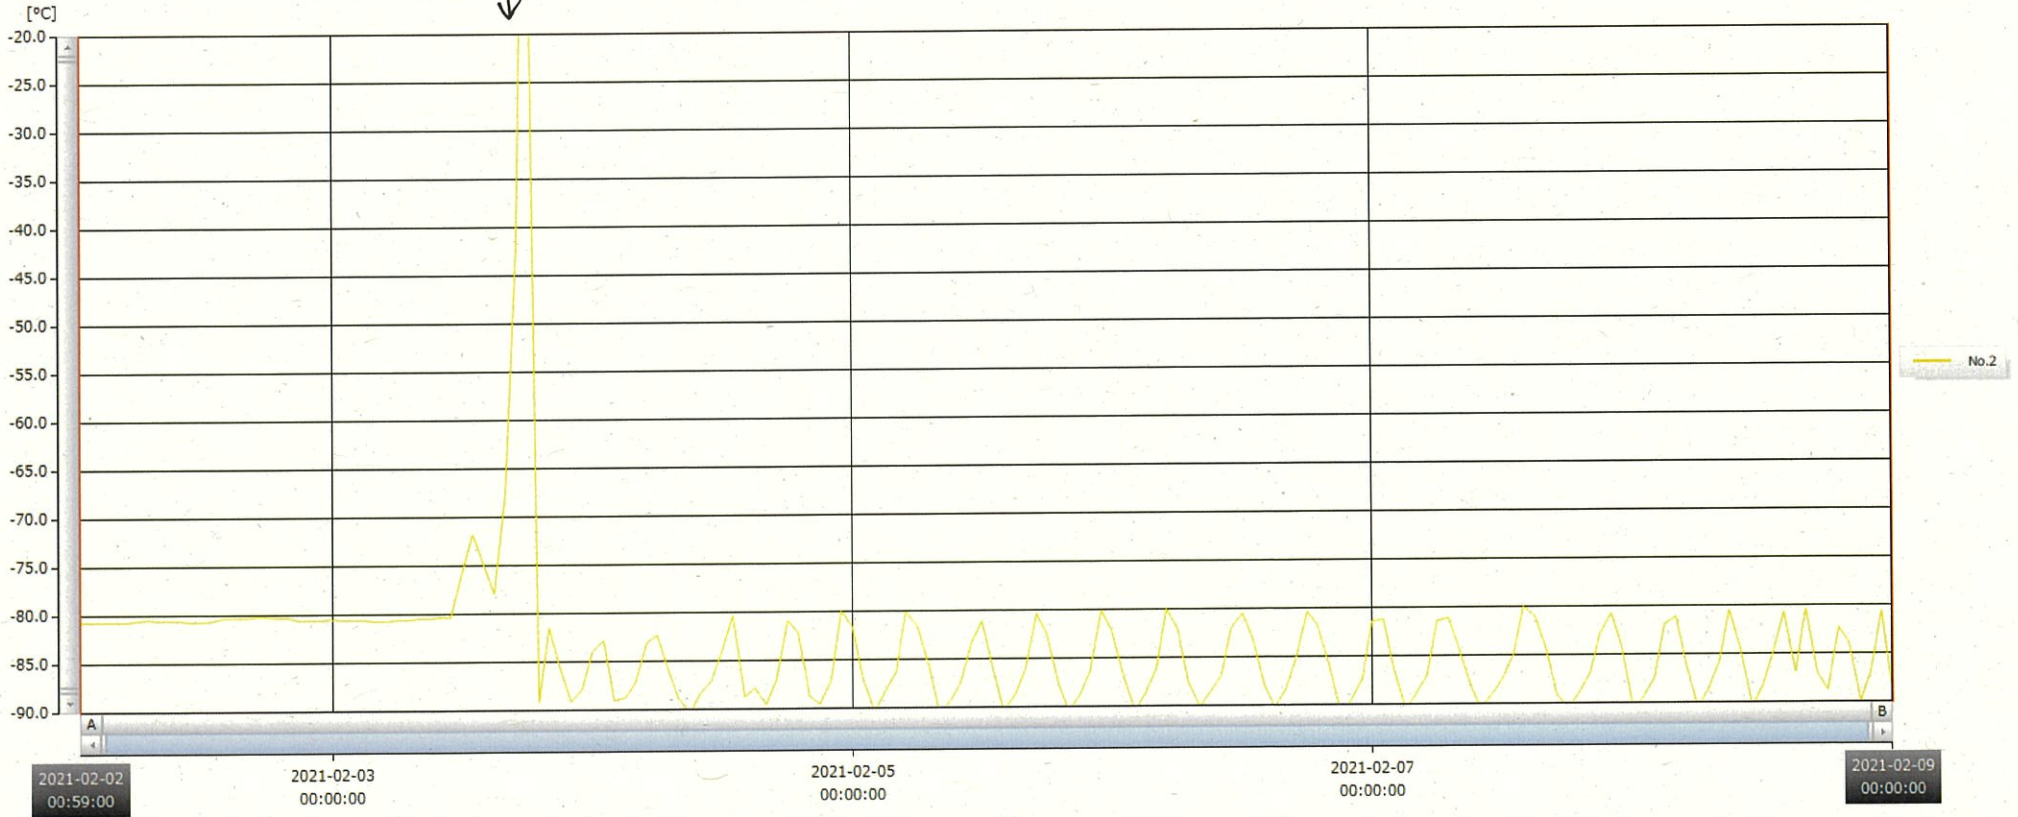

表示範囲 2021-02-02 00:59:00 - 2021-02-09 00:00:00
 計算範囲 2021-02-02 00:59:00 - 2021-02-09 00:00:00

| No. | チャンネル名 | 記録間隔 | データ数 | 単位 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|------|-------------|---------|------|----|------|-------|-------|
| No.2 | -80℃ケル Ch.1 | 60 min. | 168 | ℃ | 18.4 | -90.8 | -83.5 |