


2021.3.18 16:00 日本フリーズ CLN-32Uへ-80℃冷凍庫入れ替え。

↓

2021.3.18 16:00 ~ 2021.3.22 9:00の期間、保存検体なし。  
 -80℃冷凍庫入れ替えにより調整が為。 2021.3.23 M.H

←-----→

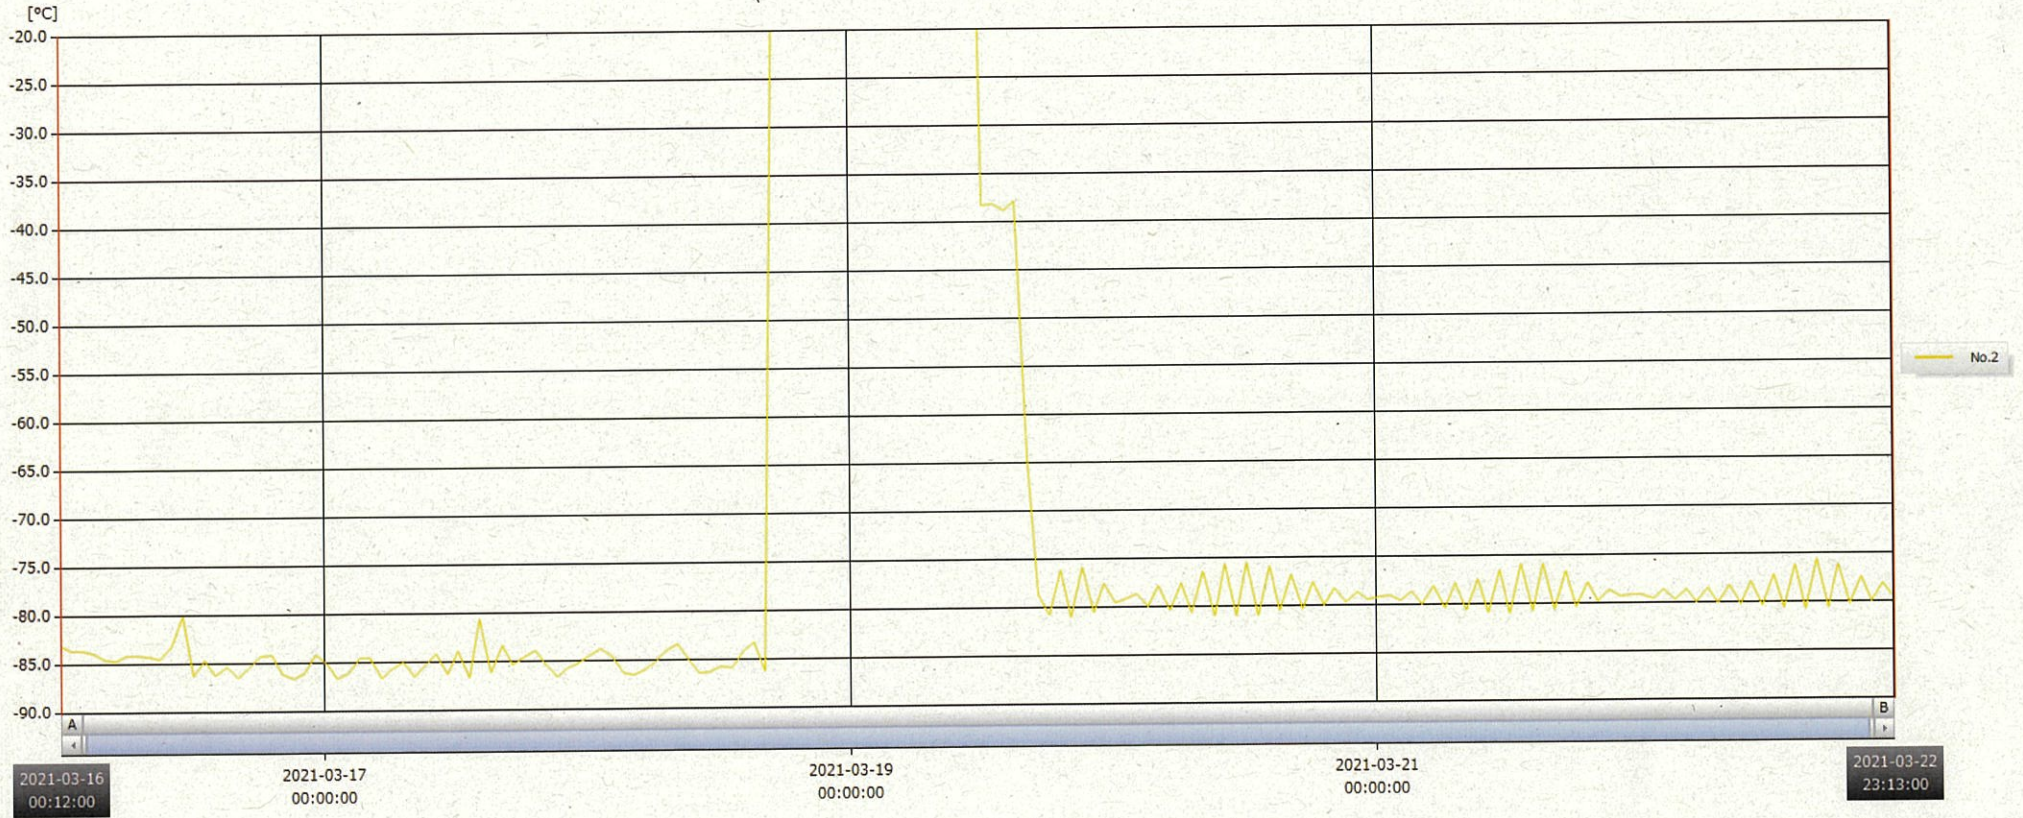

表示範囲 2021-03-16 00:12:00 - 2021-03-22 23:13:00  
 計算範囲 2021-03-16 00:12:00 - 2021-03-22 23:13:00

No.	チャンネル名	記録間隔	データ数	単位	最大値	最小値	平均値
No.2	-80℃検 Ch.1	60 min.	168	℃	26.0	-86.7	-69.4