


2022.5.20 検体用冷蔵庫交換開始 (KGT-40(DHC))
 16:00
 2022.5.23 8:31 庫内温度確認 主検体保管なし
 ←—————→

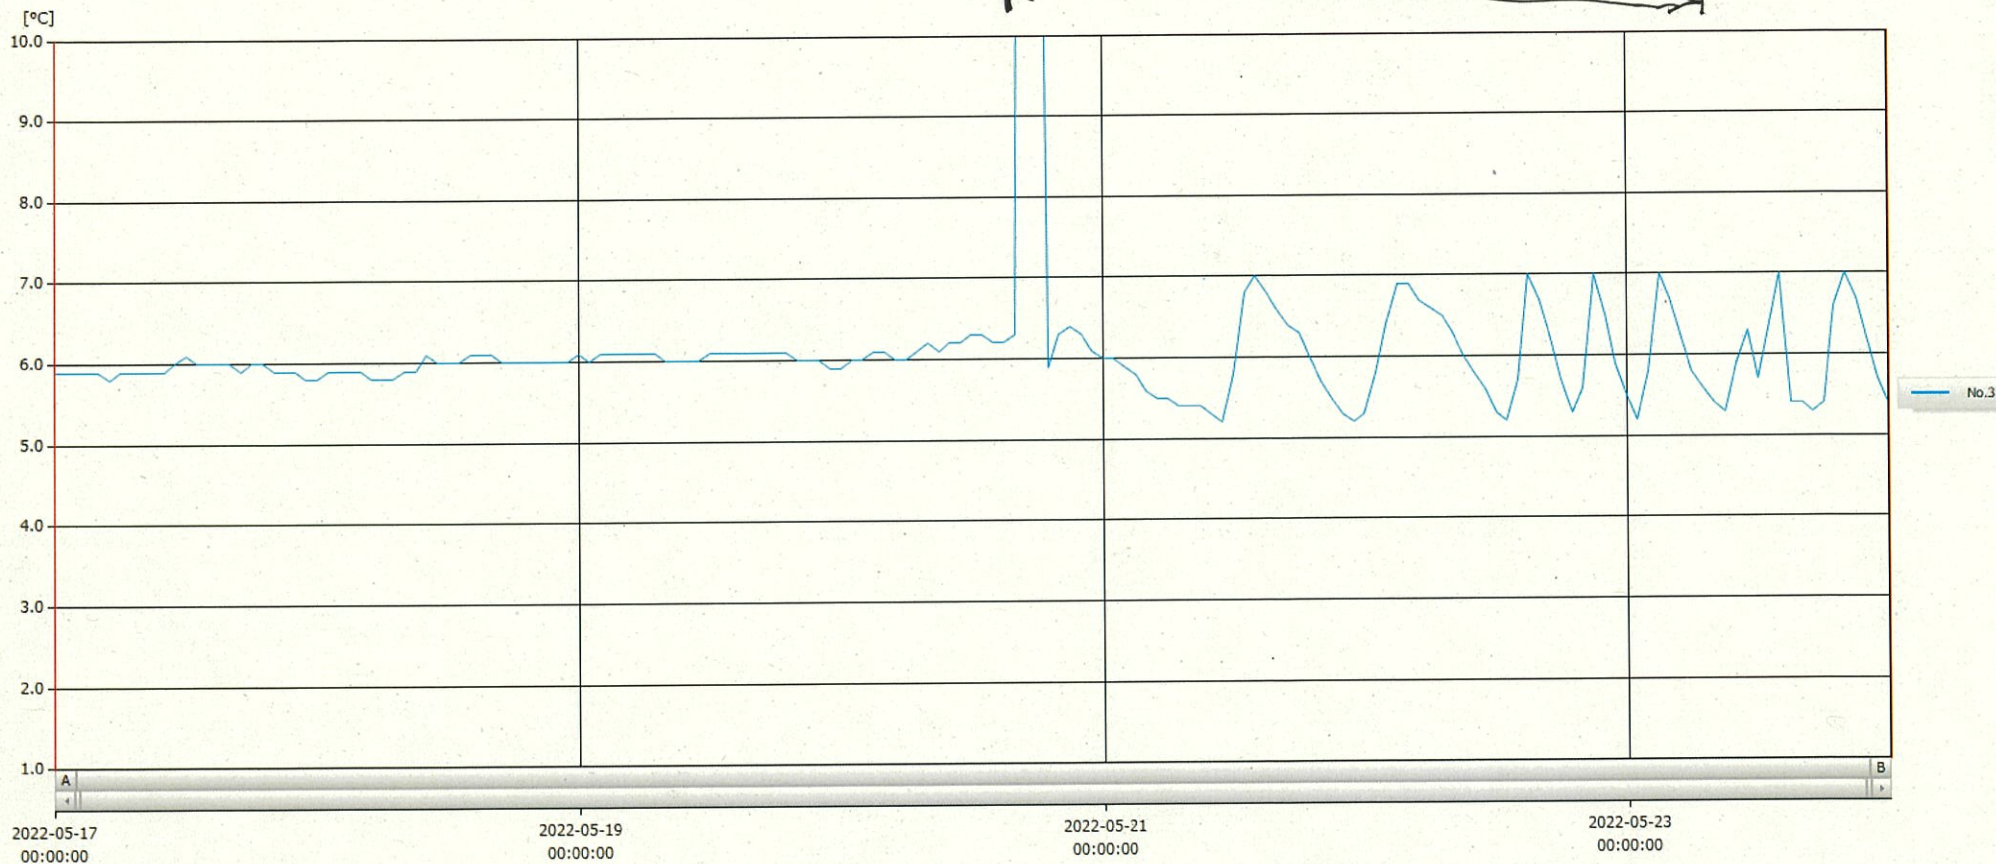

表示範囲 2022-05-17 00:00:00 - 2022-05-24 00:01:00
 計算範囲 2022-05-17 00:00:00 - 2022-05-24 00:01:00

No.	チャンネル名	記録間隔	データ数	単位	最大値	最小値	平均値
No.3	レイウ検	60 min.	169	°C	24.1	5.2	6.2

24 MAY 2022 深木 美幸